DIF

Руководство пользователя

Хирургический протокол

Последовательный выбор фрез

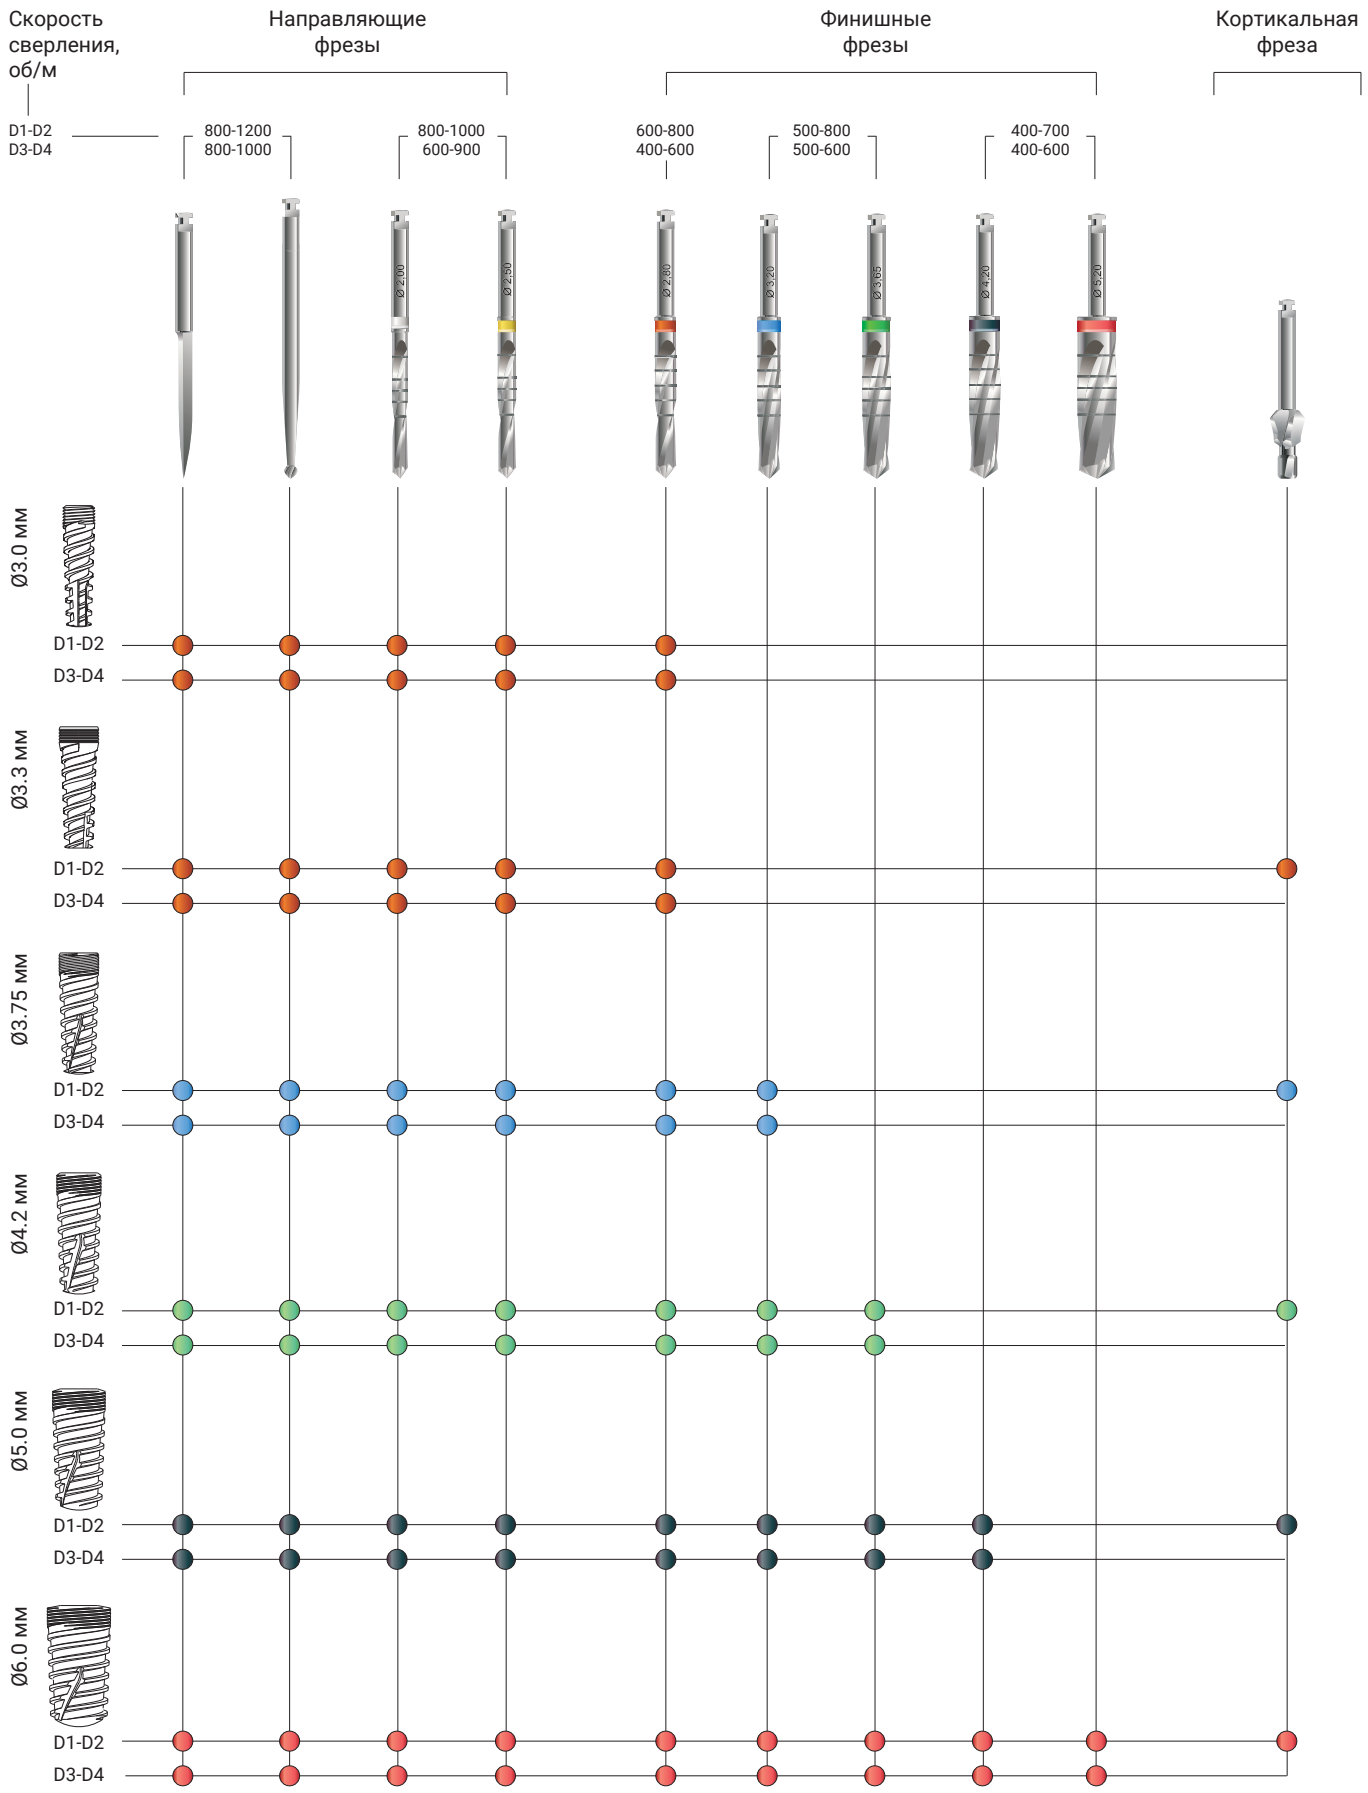

Данный протокол рекомендуем для всех видов имплантатов системы DIF. Используя финишные цилиндрические фрезы при установке конических имплантатов, необходимо проходить 2/3 от длины устанавливаемого имплантата.

Формирование ложа имплантата

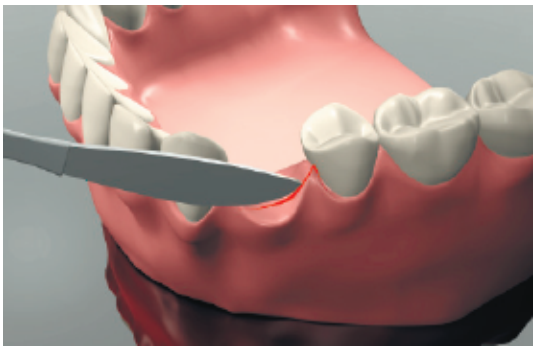

После проведения адекватной анестезии произведите разрез по гребню альвеолярного отростка в зоне предполагаемого вмешательства. Отслоите слизисто-надкостничный лоскут.

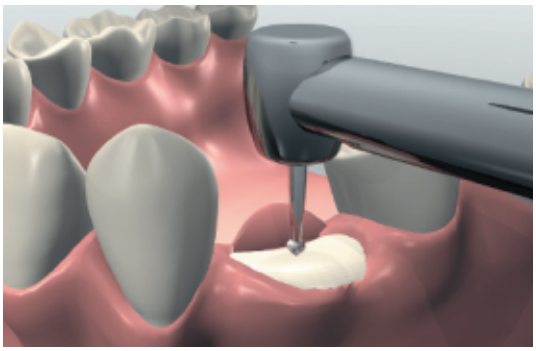

Препарируйте кортикальный слой кости в области оси предполагаемого ложа имплантата при помощи метчика и шаровидного бора.

Ø2.0 – H19.0 мм – GD-200
Ø1.5 – H19.0 мм – GD-201
Ø1.2 – H13.5 мм – GD-202

Ø1.80 – H30.0 мм – RB-190 бор с внутренним охлаждением
Ø1.90 – H34.0 мм – RB-191 бор-метчик
Ø1.80 – H30.0 мм – RB-192 бор с внешним охлаждением
Ø1.80 – H34.0 мм – RB-193 бор с внешним охлаждением

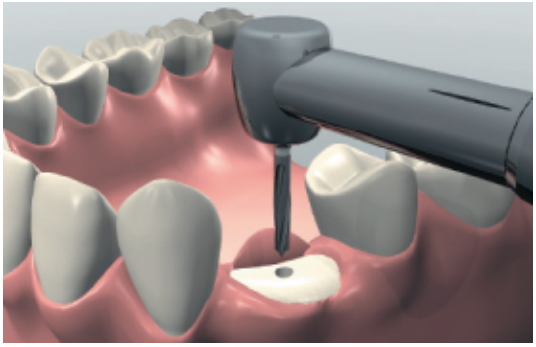

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую глубину при помощи пилотной фрезы диаметром 2.0 мм.

Ø2.0 – L16 мм – PD-200 – с внешним охлаждением
Ø2.0 – L16 мм – PDI-200 – с внутренним охлаждением

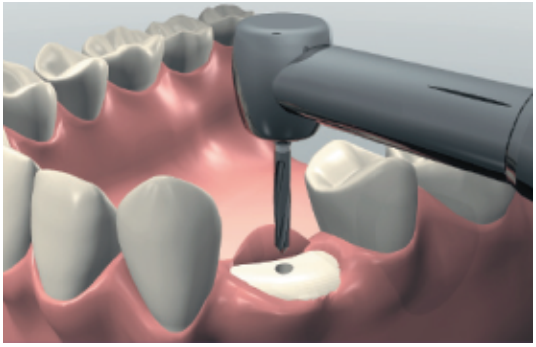

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую глубину при помощи фрезы диаметром 2.5 мм.

Ø2.5 – L16 мм – TD-250 – с внешним охлаждением
Ø2.5 – L16 мм – TDI-250 – с внутренним охлаждением

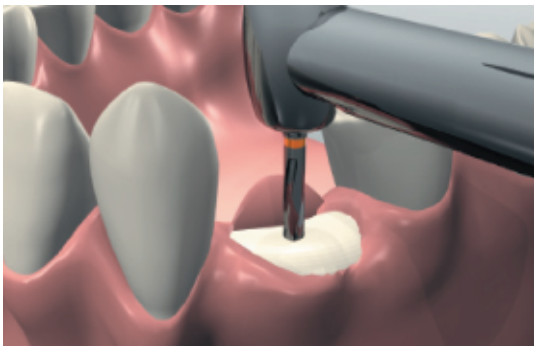

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую глубину при помощи фрезы диаметром 2.8 мм. Фреза указанного диаметра является последней при постановке имплантата диаметром 3,3 мм.

Ø2.8 – L16 мм – TD-280 – с внешним охлаждением
Ø2.8 – L16 мм – TDI-280 – с внутренним охлаждением

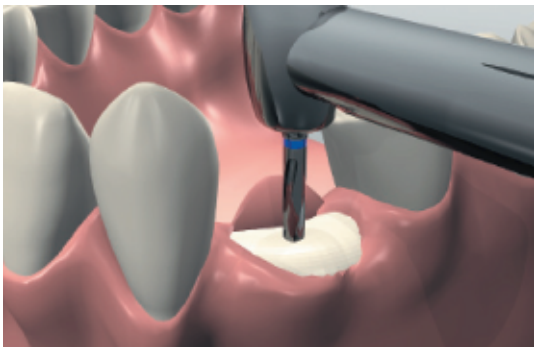

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую глубину при помощи фрезы диаметром 3.2 мм. Фреза указанного диаметра является последней при постановке имплантата диаметром 3.75 мм.

Ø3.2 – L16 мм – TD-320 – с внешним охлаждением
Ø3.2 – L16 мм – TDI-320 – с внутренним охлаждением

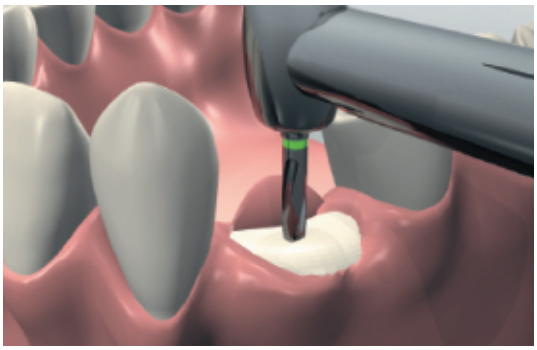

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую глубину при помощи фрезы диаметром 3.65 мм. Фреза указанного диаметра является последней при постановке имплантата диаметром 4.2 мм.



Ø3.65 – L16 мм – TD-365 – с внешним охлаждением
Ø3.65 – L16 мм – TDI-365 – с внутренним охлаждением

При необходимости продолжите препарирование ложа имплантата фрезами большего диаметра (в соответствии с диаметром выбранного имплантата).

Установка имплантата

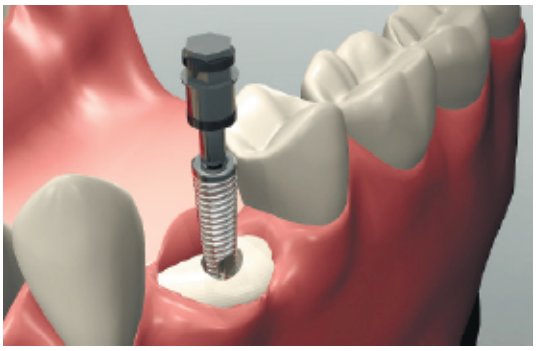

Вскройте упаковку и достаньте контейнер с имплантатом. Снимите этикетку со стерильного контейнера и достаньте капсулу с имплантатом. Извлеките носитель имплантата из капсулы. Возьмите носитель в левую руку (для левшей – в правую), правой рукой извлеките имплантат.

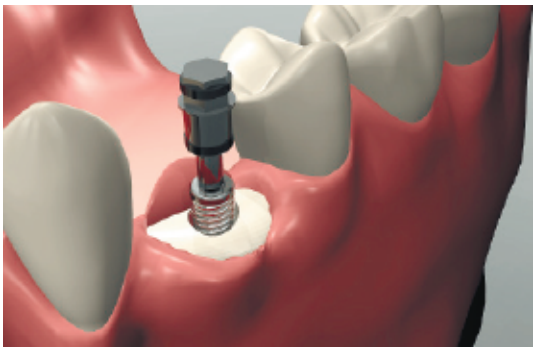

Введите имплантат (держите имплантат за имплатновод) в ложе и вручную затяните его по часовой стрелке до упора.

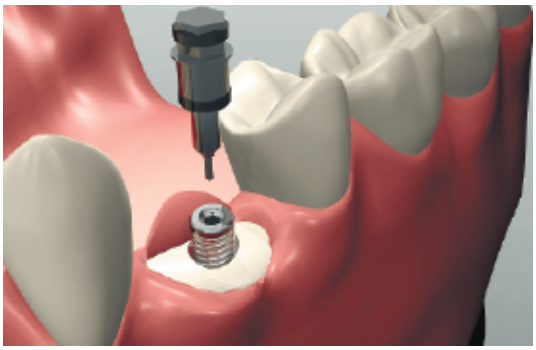

Извлеките имплантовод, потянув его вертикально вверх с незначительным усилием.

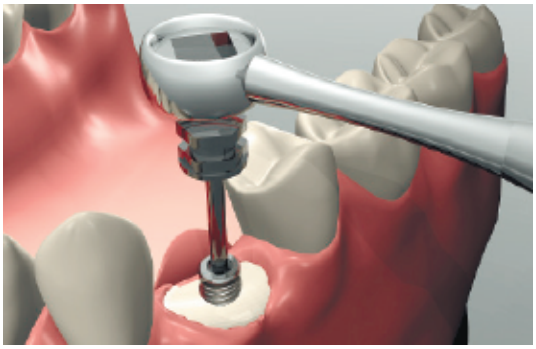

Установите в имплантат ключ 2.4 (для серии Classic) или 2.5 мм (для серии Mainstream) и затяните имплантат при помощи ратчерта.

Отвертка имплантовод Ø2.4 мм

L6 мм – PDD-24006
L9 мм – PDD-24009
L15 мм – PDD-24015
L18 мм – PDD-24018

Отвертка имплантовод Ø2.5 мм

L6 мм – CDD-25006
L9 мм – CDD-25009
L18 мм – CDD-25018

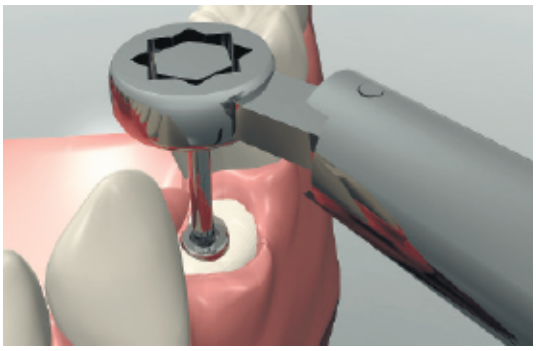

По выбору врача возможно завершить установку имплантата при помощи динамометрического ключа с усилием 30 Н/см.

Ключ динамометрический с контролем усилия
DK-545

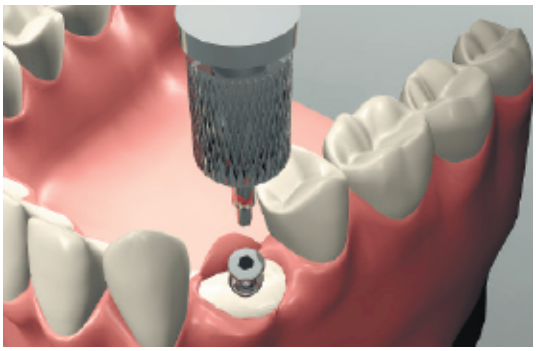

Убедитесь в отсутствии фрагментов кости и мягких тканей на ортопедической платформе имплантата и на его внутренней поверхности. Для этого промойте и просушите внутреннюю поверхность имплантата. Установите заглушку с помощью ручного шестигранного ключа диаметром 1.27 мм.

Отверка ручная для фиксации винтов, коническая Ø1.27 мм
L7 мм – HCD-12707
L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715

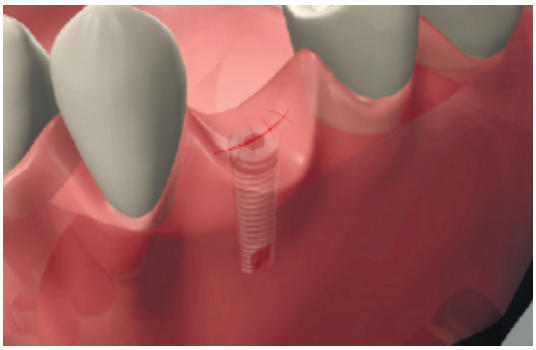

Ушейте рану узловыми швами.

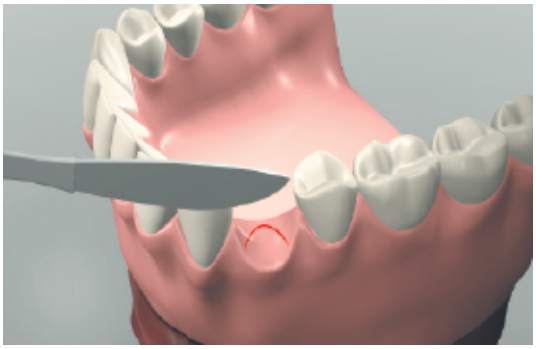

При двухэтапной установке после остеоинтеграции имплантата вскройте слизистую в области заглушки скальпелем или мукотомом.

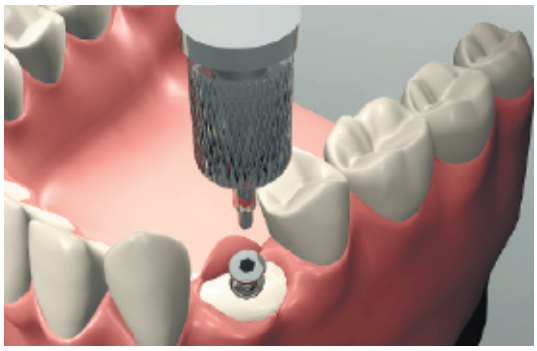

Извлеките заглушку с помощью ручного шестигранного ключа диаметром 1.27 мм.



Отверка ручная для фиксации винтов, коническая Ø1.27 мм

L7 мм – HCD-12707
L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715

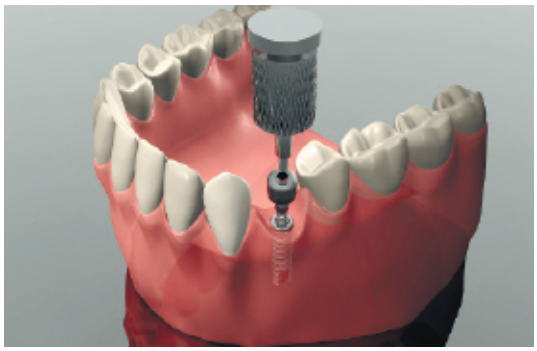

Устновите формирователь десневой манжеты с помощью ручного шестигранного ключа диаметром 1.27 мм.



Отверка ручная для фиксации винтов, коническая Ø1.27 мм

L7 мм – HCD-12707
L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715

ООО "Имплантошоп"
E-mail: implantoshop@mail.ru
Сайт: https://implantoshop.ru
Телефон: 8-800-201-84-86
8-952-372-45-92

График работы: с 10.00 до 21.00
без обеда, без выходных

Адрес: 192288 Санкт-Петербург,
пр. Дунайский, 55 кв. 70